ResMed

AirFit™ N20

Adapta-se facilmente a todos os tamanhos

Cada pessoa tem um rosto diferente. Mas com a nossa nova série AirFit™ 20, nunca foi tão fácil fazer ajustes em uma ampla gama de pacientes. Isso porque cada máscara foi especialmente concebida para se adequar a todos os pacientes, independentemente do perfil facial, eliminando assim as suposições frequentes na seleção da máscara. Com um estudo internacional recente demonstrando que a AirFit N20 se adapta a 99% dos pacientes[1], você pode confiar que ela se adequará ao seu grupo diversificado de pacientes.

ResMed.com/AirFitN20

Destaques da AirFit N20

Arnês sofisticado especificamente desenvolvido para oferecer suavidade e estabilidade extras.

Almofada InfinitySeal™ tem laços especialmente desenhados e espessuras variadas para evitar fuga de ar.

Armação macia e flexível fica posicionada abaixo dos olhos e adapta-se a diferentes tipos de rosto, enquanto a camada acolchoada integrada proporciona conforto adicional.

Cotovelo de liberação rápida para facilitar a desconexão do tubo da máscara sem removê-la.

Presilhas magnéticas guiam o arnês à armação com rapidez e facilidade.

AirFit N20 for Her

Desenvolvida especificamente para mulheres.

A AirFit N20 adaptou-se a um número significativo de 99% dos pacientes em um estudo internacional recente.[1]

Componentes da AirFit N20

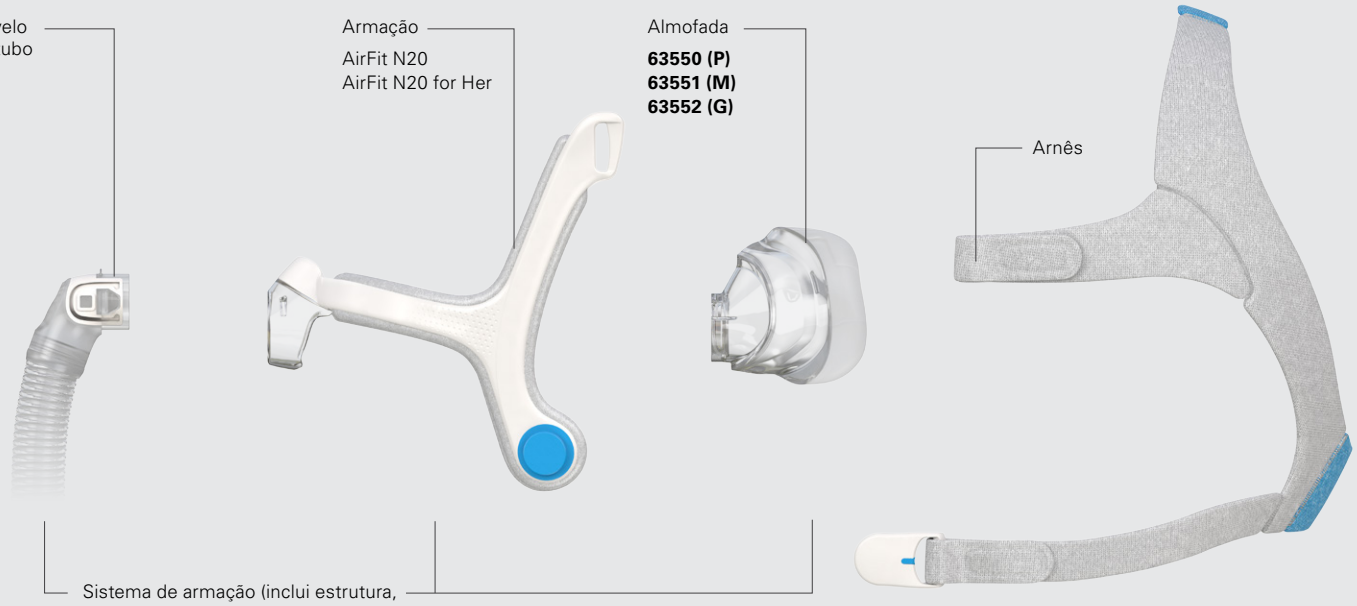

Sistema de armação (inclui estrutura, almofada e cotovelo com tubo curto)

63553 (P)
63555 (M)
63556 (G)
63554 for Her (P)

Arnês da AirFit N20 com presilhas

63560 (P)
63561 (Padrão)
63562 (G)

Arnês da AirFit N20 for Her com presilhas

63558 (P)

Códigos dos produtos

Sistemas completos de máscaras *(incluem sistema de armação + arnês)*

AirFit N20: Pequeno	**63503**
AirFit N20: Médio	**63501**
AirFit N20: Grande	**63502**
AirFit N20 for Her	**63500**

AirFit™ N20

ResMed

AirFit™ N20

Nasal Mask

Guia de ajuste da AirFit N20

- Comece verificando se os ímãs da correia inferior estão soltos.
- Se estiverem presos, gire-os e puxe-os para soltá-los da armação.

- Coloque o arnês na cabeça com o logo para o lado de fora.

- Posicione as correias inferiores para que ambas fiquem abaixo das orelhas.
- Eleve os ímãs em direção às presilhas correspondentes da armação.

- Ajuste os encaixes de fixação nas correias superiores até que a máscara fique fixa e estável.
- Prenda novamente os encaixes de fixação.

- Repita a etapa 4 com as correias inferiores.
- Prenda novamente os encaixes de fixação.

- Conecte o tubo de ar do dispositivo ao cotovelo, em seguida prenda o cotovelo na parte frontal da máscara.
- Ligue o dispositivo.

Consulte o manual do usuário para ver mais instruções e informações completas de rotulagem, incluindo indicações, contra-indicações, avisos e precauções.

1 Estudo internacional interno sobre a adaptação da AirFit N20 da ResMed em pacientes novos e existentes que usam CPAP, realizado em novembro de 2015.

Distribuído por ResMed Corp, 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego, Califórnia, 92123 – EUA, +1 858 836 5000 ou 1 800 424 0737 (ligação gratuita). Consulte o site ResMed.com para obter outras localizações da ResMed em todo o mundo. AirFit e InfinitySeal são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da família de empresas ResMed. As especificações podem mudar sem aviso prévio. © 2016 ResMed. 1019436/1 2016-10

ResMed.com/AirFitN20

℞ Only